

BRANE
Catalogo/Catalogue

Tecom

IMPLANTOLOGY

PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

CC SYSTEM	Compatibile con	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con	Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™
FRIA	Compatibile con	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®
PT	Compatibile con	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)
REP	Compatibile con	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®
STR	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®
STR BL	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.

The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers. Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

INDICE

INDEX

Caratteristiche del sistema implantare BRANE BRANE implant system features	pag.4
Preparazione sito impantare e posizionamento impianto Implant site preparation and implant positioning	pag. 7
- Impianti - Implants	
Presca d'impronta Impression taking	pag. 10
- Componenti da laboratorio - Lab components	
Protesizzazione Prosthetic workflow	pag. 12
- Parti protesiche - Prosthetic parts	
Mua (multi unit abutment) per overdenture Mua (multi unit abutment) for overdenture	pag. 16
- MUA - MUA - Componenti da laboratorio per MUA - MUA Lab components - Parti protesiche per MUA - MUA Prosthetic parts	
Strumentario Tools	pag. 22

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPLANTARE BRANE BRANE IMPLANT SYSTEM FEATURES

IMPIANTO SYSTEM TU. SYSTEM TU. IMPLANT



Connessione esagonale esterna con 6 posizioni per l'abutment (a seconda dell'abutment).

External hexagonal connection with 6 abutment positions (depending on the abutment).

Corpo cilindrico con filetto a due principi

Cylindrical body shape with two-principle threads

Trattamento di superficie SL Titanmed, compatibile con i migliori trattamenti SLA™

SL Titanmed surface treatment, compatible with the best SLA™ treatments

Bordi di taglio poco profondi sui filetti

Shallow cutting edges on threads

Forma dell'apice: piatta

Apex shape: flat

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE SL TITANMED SL TITANMED SURFACE TREATMENT

Il trattamento SL Titanmed è tecnicamente comparabile ai migliori SLA™ maggiormente documentati in letteratura. Viene realizzato con una tecnica di sabbiatura con una tecnologia che permette la massima costanza di trattamento. A questa segue la mordenzatura con soluzioni acide. La sabbiatura genera sulla superficie dell'impianto una macrorugosità, a cui si sovrappone una micro-rugosità ottenuta tramite il processo di mordenzatura acida. La topografia superficiale che ne deriva genera la struttura idonea all'ancoraggio delle cellule osteoblaste e favorisce un'ottima integrazione dell'impianto con il tessuto osseo.

The Titanmed SL treatment is comparable with the best SLA™ treatments, documented in scientific journals. It is realized using sand-blasting technique with a technology which allows the maximum consistency of treatment. After this, the surface is etched with acid solutions. The sand-blasting step creates a macro roughness on the surface of the implant, then a micro roughness is formed on top of these with the acid etching process. The resulting texture of the surface generates a structure that is suitable for anchoring osteoblast cells, favouring the optimal integration of the implant with the bone tissue.

IMPIANTO SPEEDY GR. TU. SPEEDY GR. TU. IMPLANT



Connessione esagonale esterna con 6 posizioni per l'abutment (a seconda dell'abutment).

External hexagonal connection with 6 abutment positions (depending on the abutment).

Morfologia del corpo lievemente conica

Slightly tapered body shape

Filetto a due principi

Two-principle threads

Trattamento di superficie SL Titanmed, compatibile con i migliori trattamenti SLA™

SL Titanmed surface treatment, compatible with the best SLA™ treatments

Apice conico automaschiante con scanalature di taglio

Tapered self-tapping apex with bone cutting flutes

MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medicale di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medicale Grado 5.

Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A. is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

VITE TAPPO COVER SCREW



Titanmed produce viti tappo con l'impronta esagonale 0,90 mm.

Titanmed produces cover screw with the 0,90 hex type impression.

VITE DI CONNESSIONE CONNECTING SCREW



Titanmed le produce con l'impronta tipo UNIGRIP™

Titanmed produces them with the UNIGRIP™ type impression

Le viti di connessione delle parti protesiche nonostante abbiano stesso filetto e impronta possono essere, a seconda del diametro dell'impianto, differenti per lunghezza totale, altezza testa, inclinazione sottotesta, ecc.


The connecting screws of the prosthetic parts have the same thread and the same imprint may be different, depending on the diameter of the implant, in terms of overall length, head height, inclination under the head, etc.

NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

IMPIANTO IMPLANT	35-45 Ncm
VITE TAPPO COVER SCREW	15 Ncm
COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS	5-10 Ncm
PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS	35 Ncm
MUA MUA	30 Ncm
MUA COMPONENTI DA LABORATORIO MUA LAB COMPONENTS	5-10 Ncm
MUA PARTI PROTESICHE MUA PROSTHETIC PARTS	15 Ncm

PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO


IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING

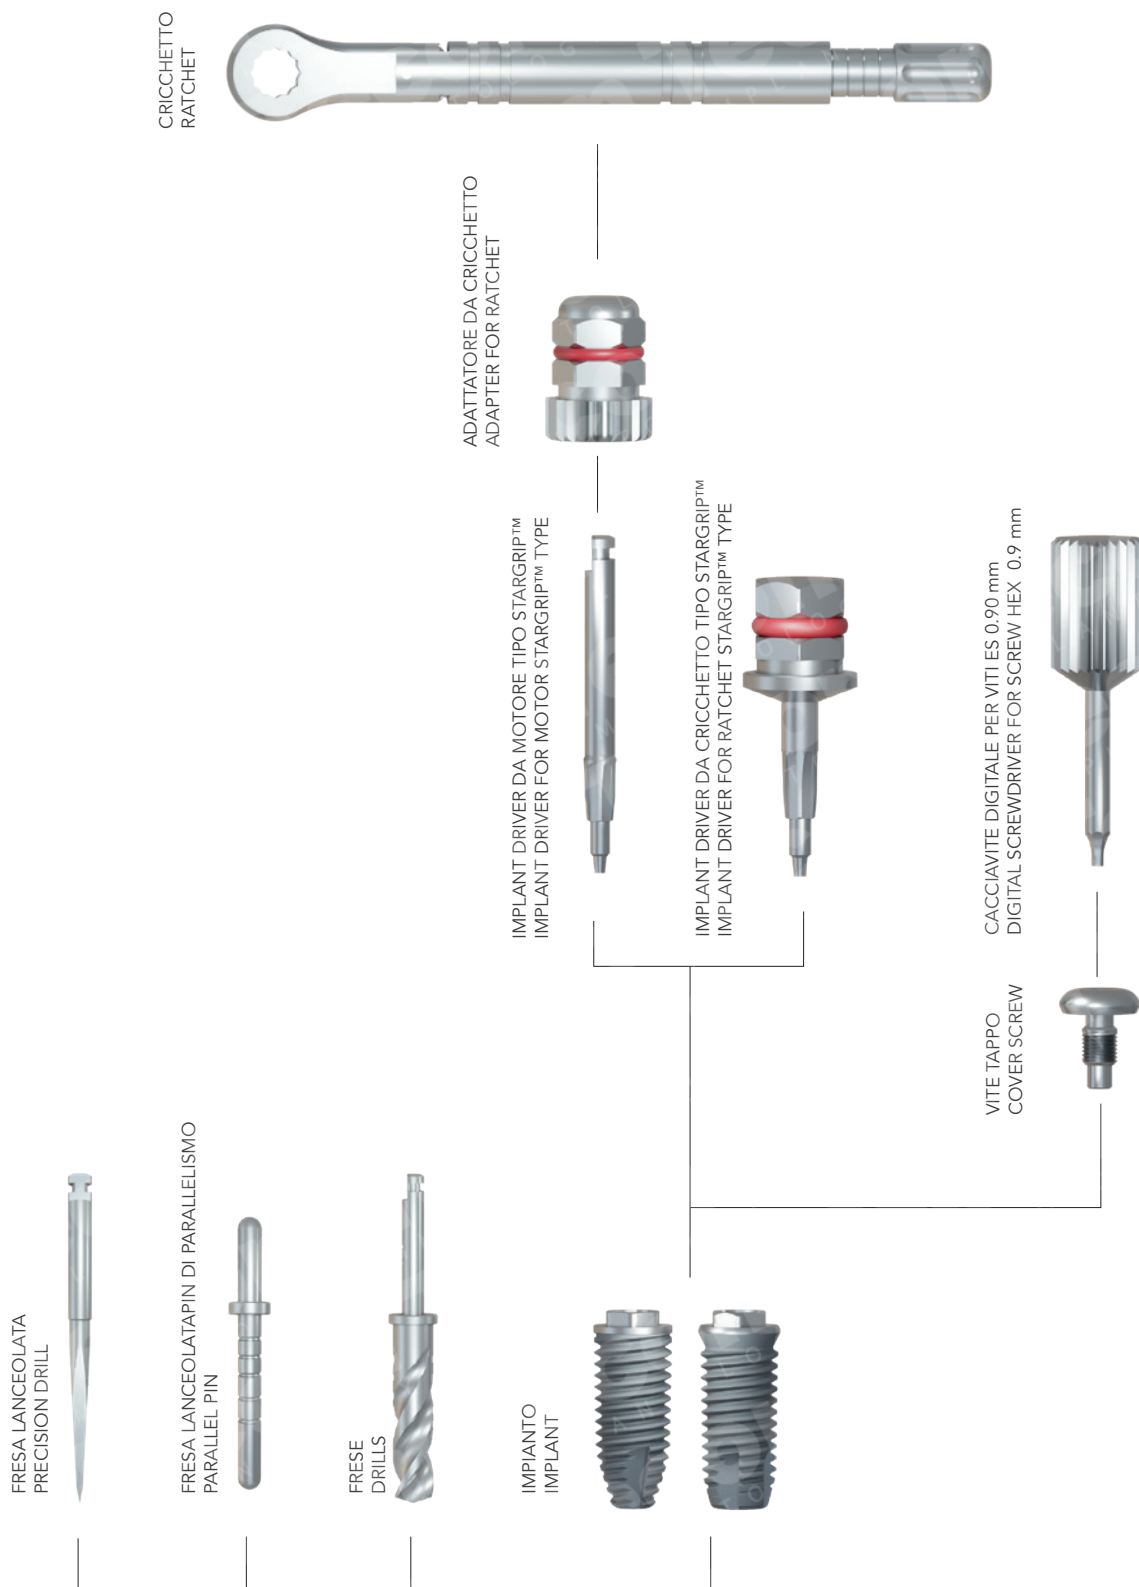

01 IMPIANTI BRANE SYSTEM TU. IMPLANTS BRANE SYSTEM TU.


IMPIANTO SYSTEM TU. Ø3.75
IMPLANT SYSTEM TU. Ø3.75

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

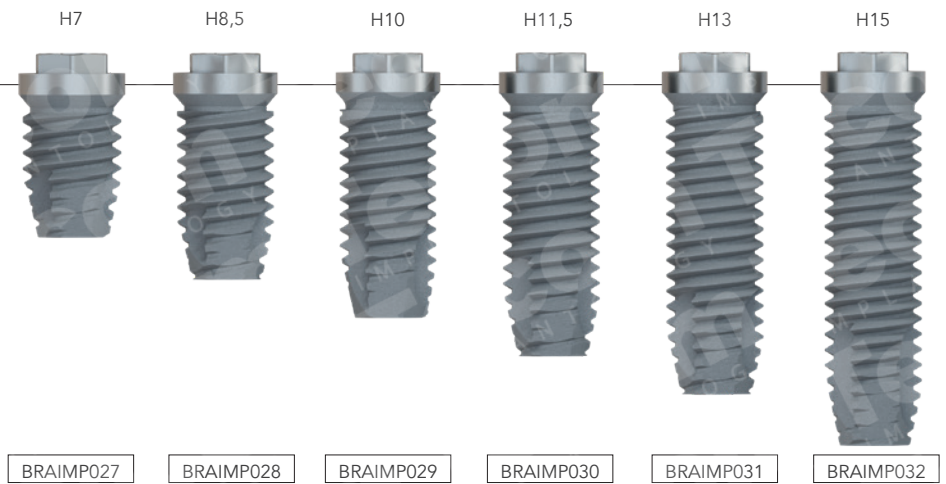


IMPIANTO SYSTEM TU. Ø4.0
IMPLANT SYSTEM TU. Ø4.0

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

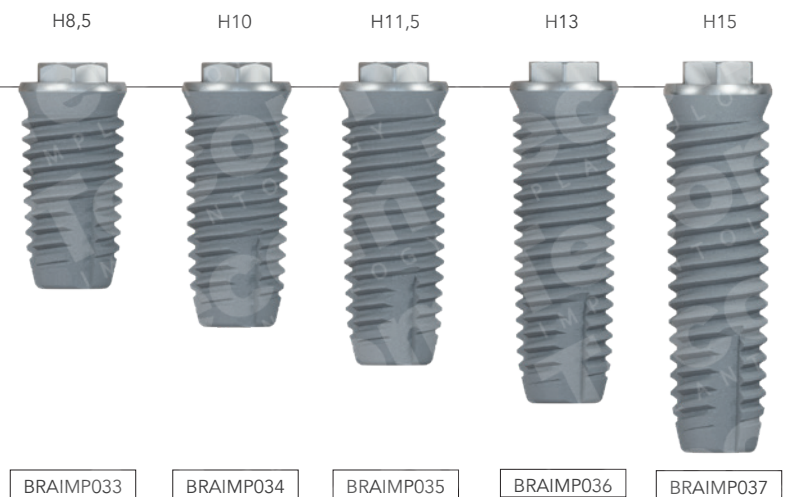

IMPIANTO SYSTEM TU. Ø5.0
IMPLANT SYSTEM TU. Ø5.0

Vite tappo inclusa anodizzata secondo
codice colore.
Cover screw included anodized according
to color code.

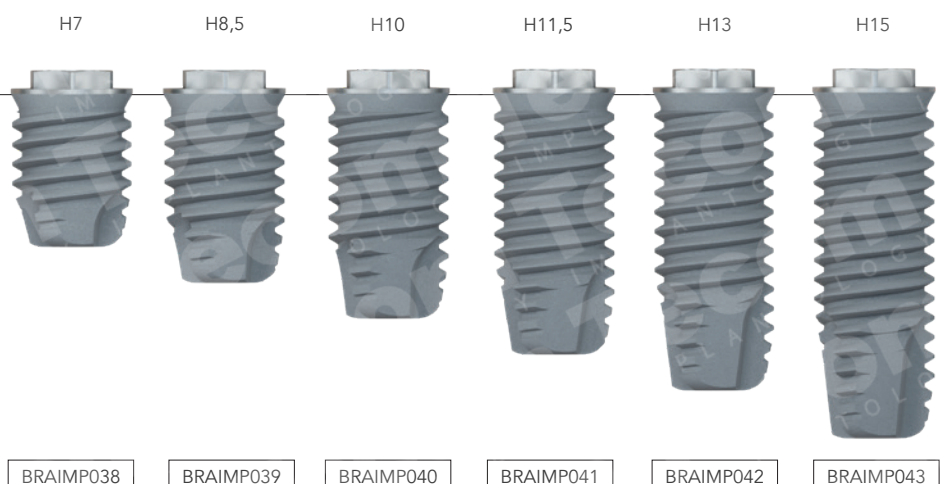

01 IMPIANTI BRANE SPEEDY GR. TU. IMPLANTS BRANE SPEEDY GR TU.

IMPIANTO SPEEDY GR. TU. Ø4.0
IMPLANT SPEEDY GR. TU. Ø4.0

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

BRANE


H8,5



H10



H11,5



H13



H15




H18




H20



H22



H25



BRAIMP060

BRAIMP059

BRAIMP057

BRAIMP047

BRAIMP048

BRAIMP058

BRAIMP073

BRAIMP074

BRAIMP075

PRESA D'IMPRONTA
IMPRESSION TAKINGCACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™TRANSFER OPEN TRAY
IMPRESSION COPING OPEN TRAYIMPIANTO
IMPLANTANALOGO
IMPLANT REPLICA

02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY IMPRESSION COPING OPEN TRAY



	3,75	BRAPPR095
∅	4	BRAPPR095
	5	BRAPPR096

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included


ANALOGO IMPLANT REPLICA



	3,75	BRAPPR066
∅	4	BRAPPR066
	5	BRAPPR067

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

PROTESIZZAZIONE
PROSTHETIC WORKFLOW

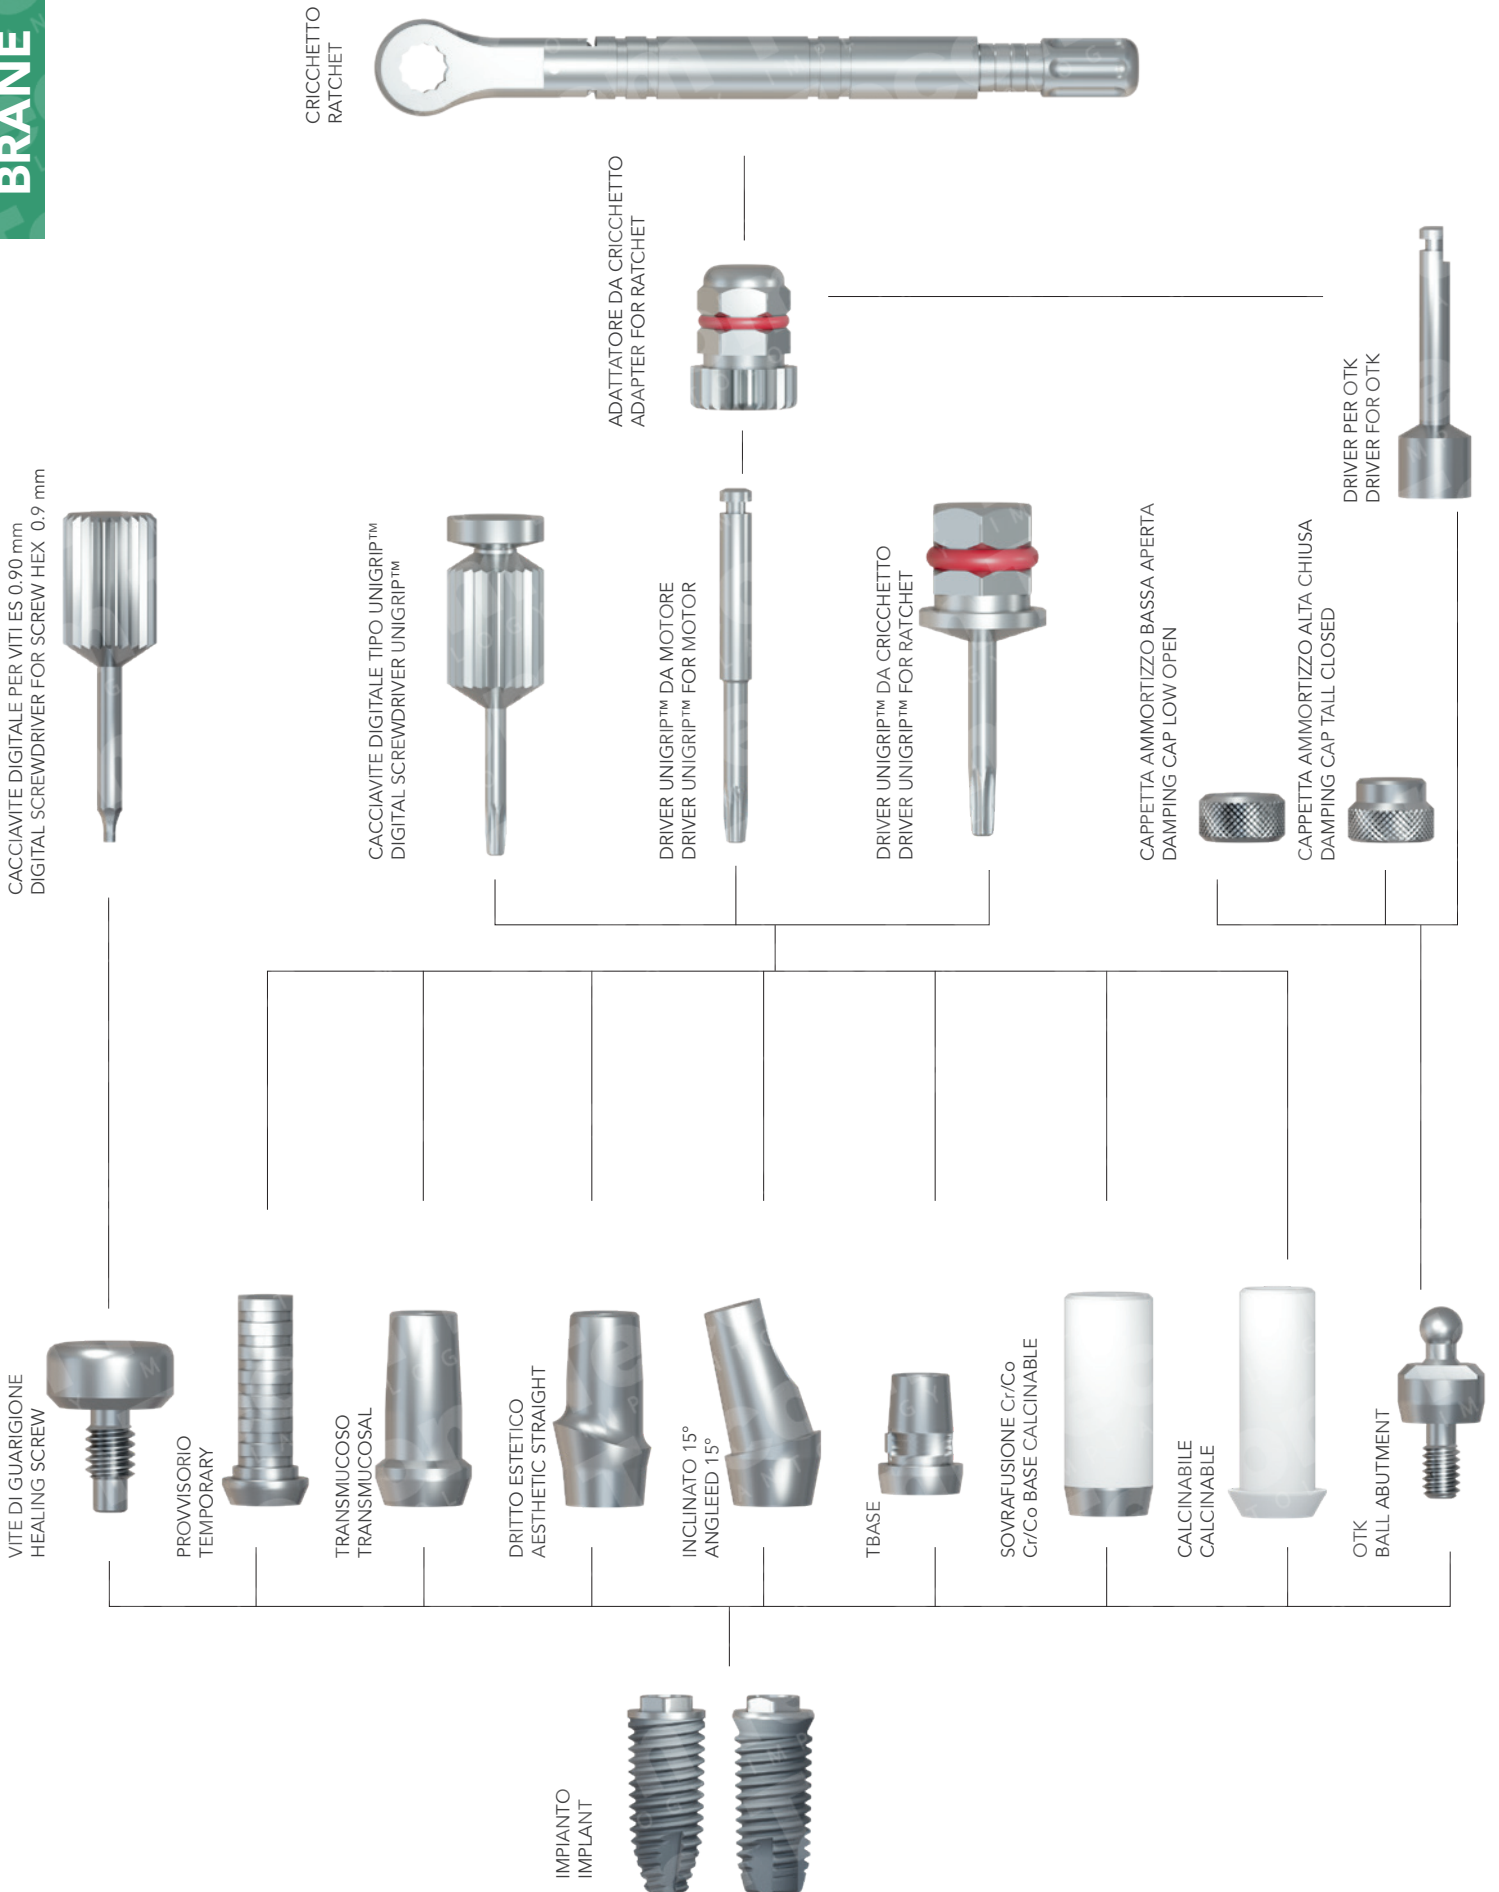

03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

VITE DI GUARIGIONE (ES. 0,90) HEALING SCREW (HEX. 0,90)



		H	
		2	4
∅	3,75	BRAVIT032	BRAVIT033
	4	BRAVIT032	BRAVIT033
	5	BRAVIT034	BRAVIT035

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE TEMPORARY NON ROTATING ABUTMENT



∅	3,75	BRAPPR139
	4	BRAPPR139

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE TEMPORARY ROTATING ABUTMENT



∅	3,75	BRAPPR140
	4	BRAPPR140

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE TRASMUCOSO TRANSMUCOSAL ABUTMENT



		H	
		2	
∅	3,75	BRAPPR045	
	4	BRAPPR045	
	5	BRAPPR046	

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



MONCONE ESTETICO DRITTO AESTHETIC STRAIGHT ABUTMENT

		H	
		1	3
Ø	3,75	BRAPPR130	BRAPPR131
	4	BRAPPR130	BRAPPR131

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



MONCONE INCLINATO 15° 15° ANGLED ABUTMENT

		H	
		1,5	2,5
Ø	3,75	BRAPPR048	BRAPPR049
	4	BRAPPR048	BRAPPR049
	5	BRAPPR050	/

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



MONCONE TBase TBase ABUTMENT

Ø	3,75	BRAPPR129
	4	BRAPPR129

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included
Fornito senza Scanbody. Per il rilevamento di posizione con scanner intraorale, il moncone TBase è compatibile con la misura Large degli Scanbody Sirona™ Cerec. Scanbody not included. For digital impression with intraoral scanner, the TBase is compatible with Scanbody Sirona™ Cerec, size Large.



MONCONE SOVRAFUSIONE NON ROTANTE Cr/Co NON ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUTMENT

Ø	3,75	BRAPPR134
	4	BRAPPR134

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE NON ROTATING CALCINABLE ABUTMENT

Ø	3,75	BRAPPR054
	4	BRAPPR054
	5	BRAPPR055

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



MONCONE CALCINABILE ROTANTE
ROTATING CALCINABLE ABUTMENT

	3,75	BRAPPR051
∅	4	BRAPPR051
	5	BRAPPR053

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



MONCONE A PALLINA (OTK)
BALL ABUTMENT (OTK)

		H	
		1	2
	3,75	BRAPPR069	BRAPPR070
∅	4	BRAPPR069	BRAPPR070

CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA IN
TITANIO CON O-RING
TITANIUM DAMPING CAP LOW, OPEN WITH O-RING



BRAPPR090

O-RING CONFEZIONE 10 PZ.
O-RING 10 PCS PACK

BRAPPR105

CAPPETTA AMMORTIZZO ALTA CHIUSA IN
TITANIO CON O-RING
TITANIUM DAMPING CAP TALL, CLOSED WITH O-RING



BRAPPR091

O-RING CONFEZIONE 10 PZ.
O-RING 10 PCS PACK


BRAPPR105

BARRETTA DI SALDATURA (10 PZ.)
WELDING BAR (10 PCS)




	1.2	VARPPR006
∅	1.5	VARPPR005
	2	VARPPR004

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) PER OVERDENTURE - POSIZIONAMENTO
 MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) FOR OVERDENTURE - POSITIONING

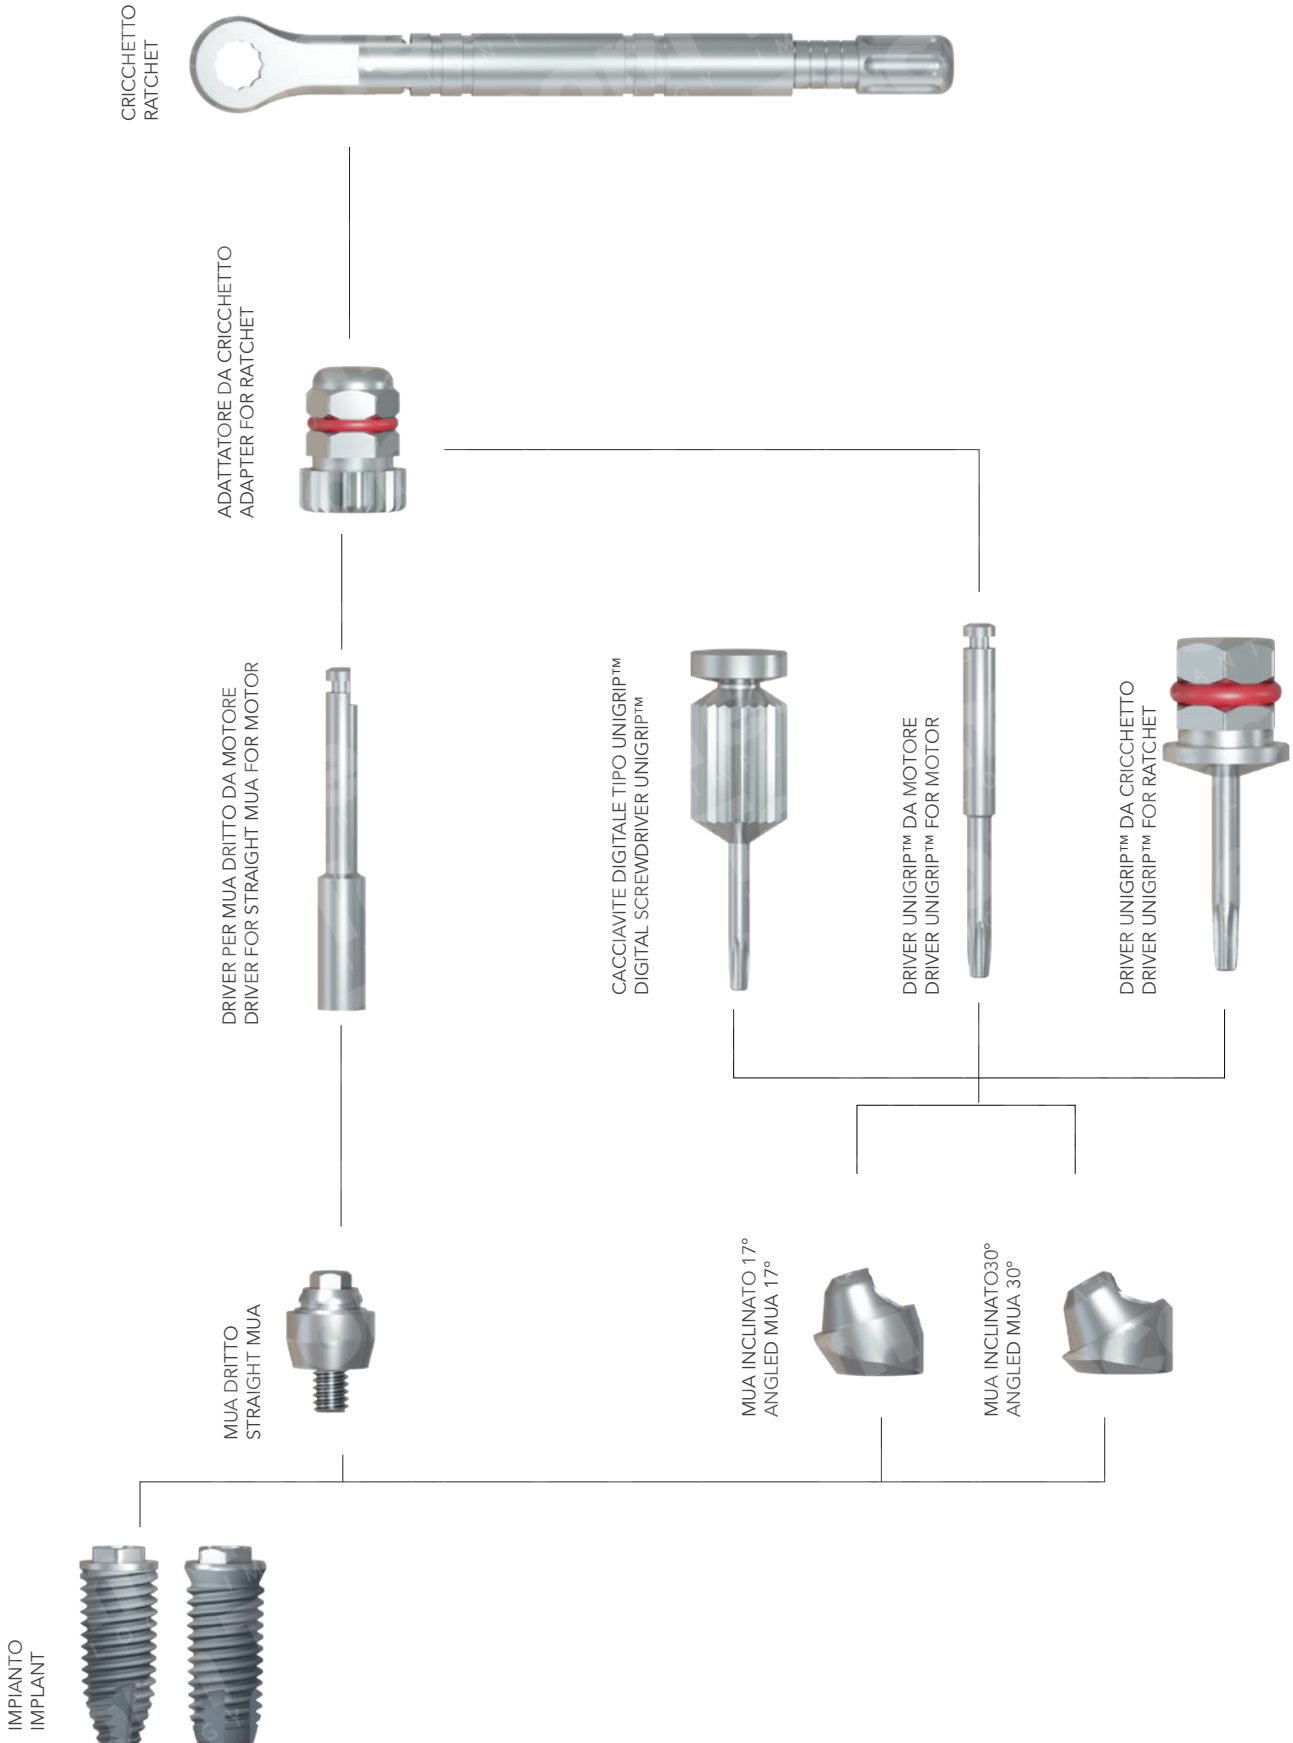


MUA PER OVERDENTURE - PRESA D'IMPRONTA

MUA FOR OVERDENTURE - IMPRESSION TAKING

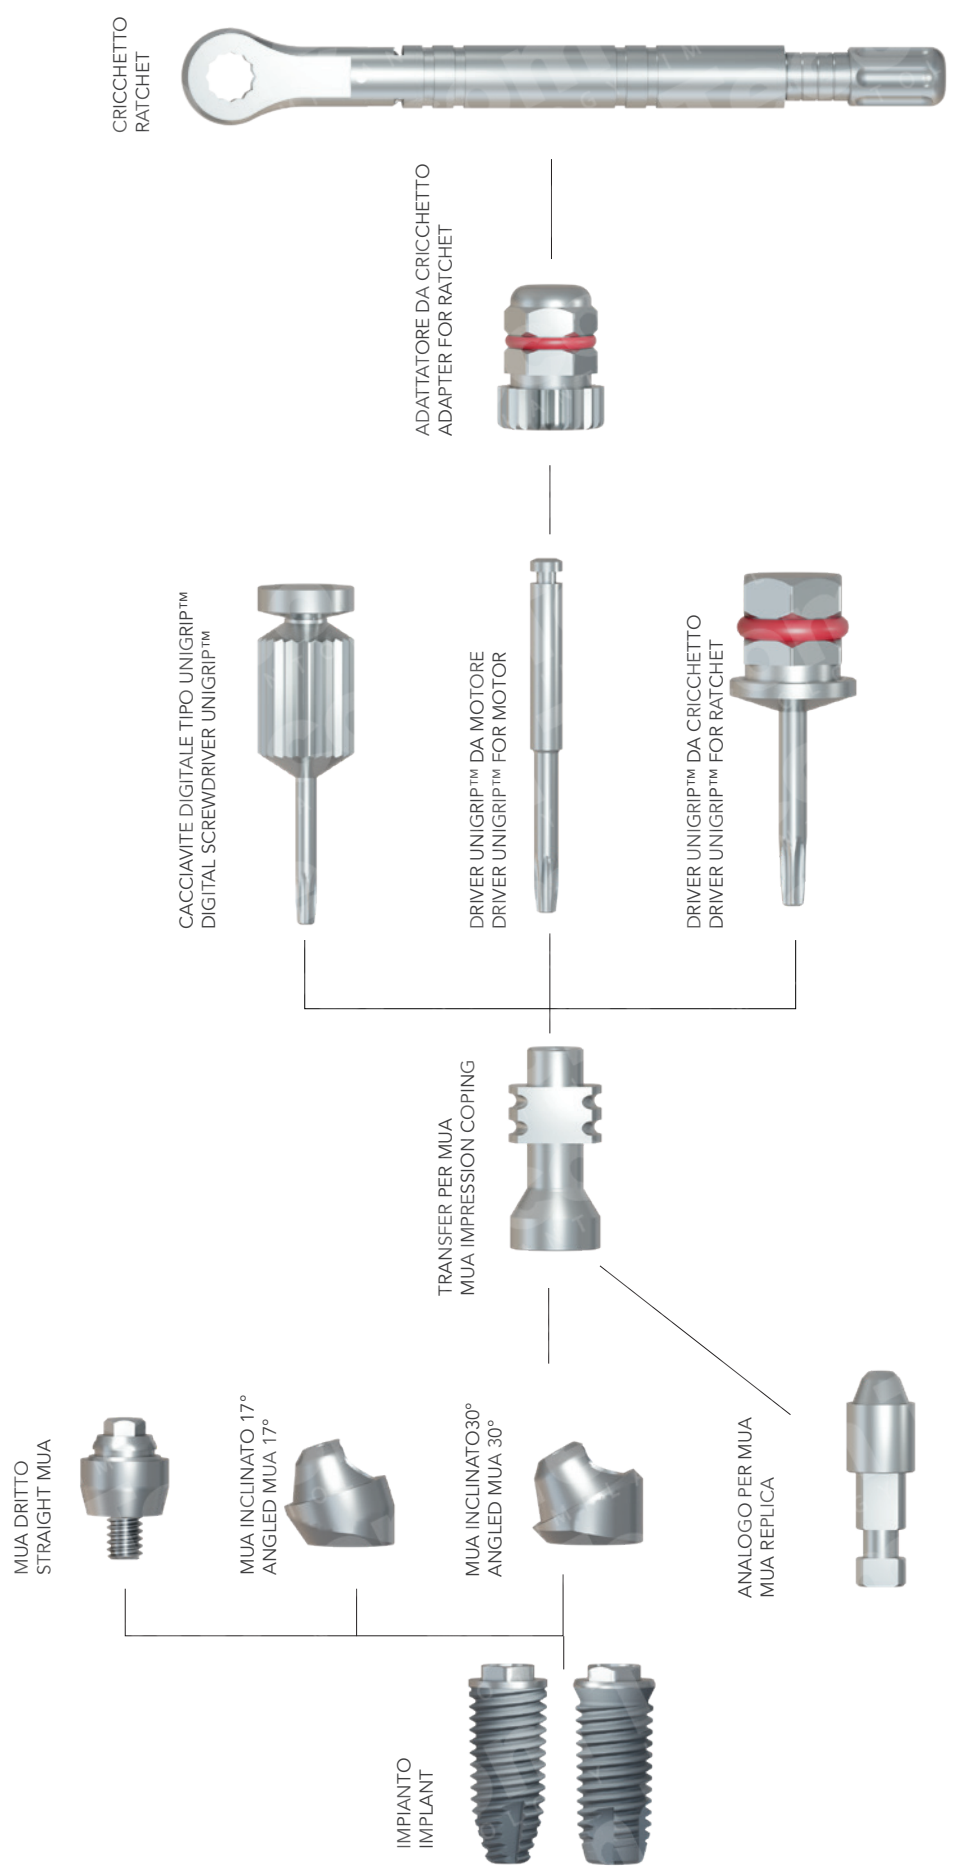

MUA PER OVERDENTURE - PROTESIZZAZIONE

MUA FOR OVERDENTURE - PROSTHETIC WORKFLOW

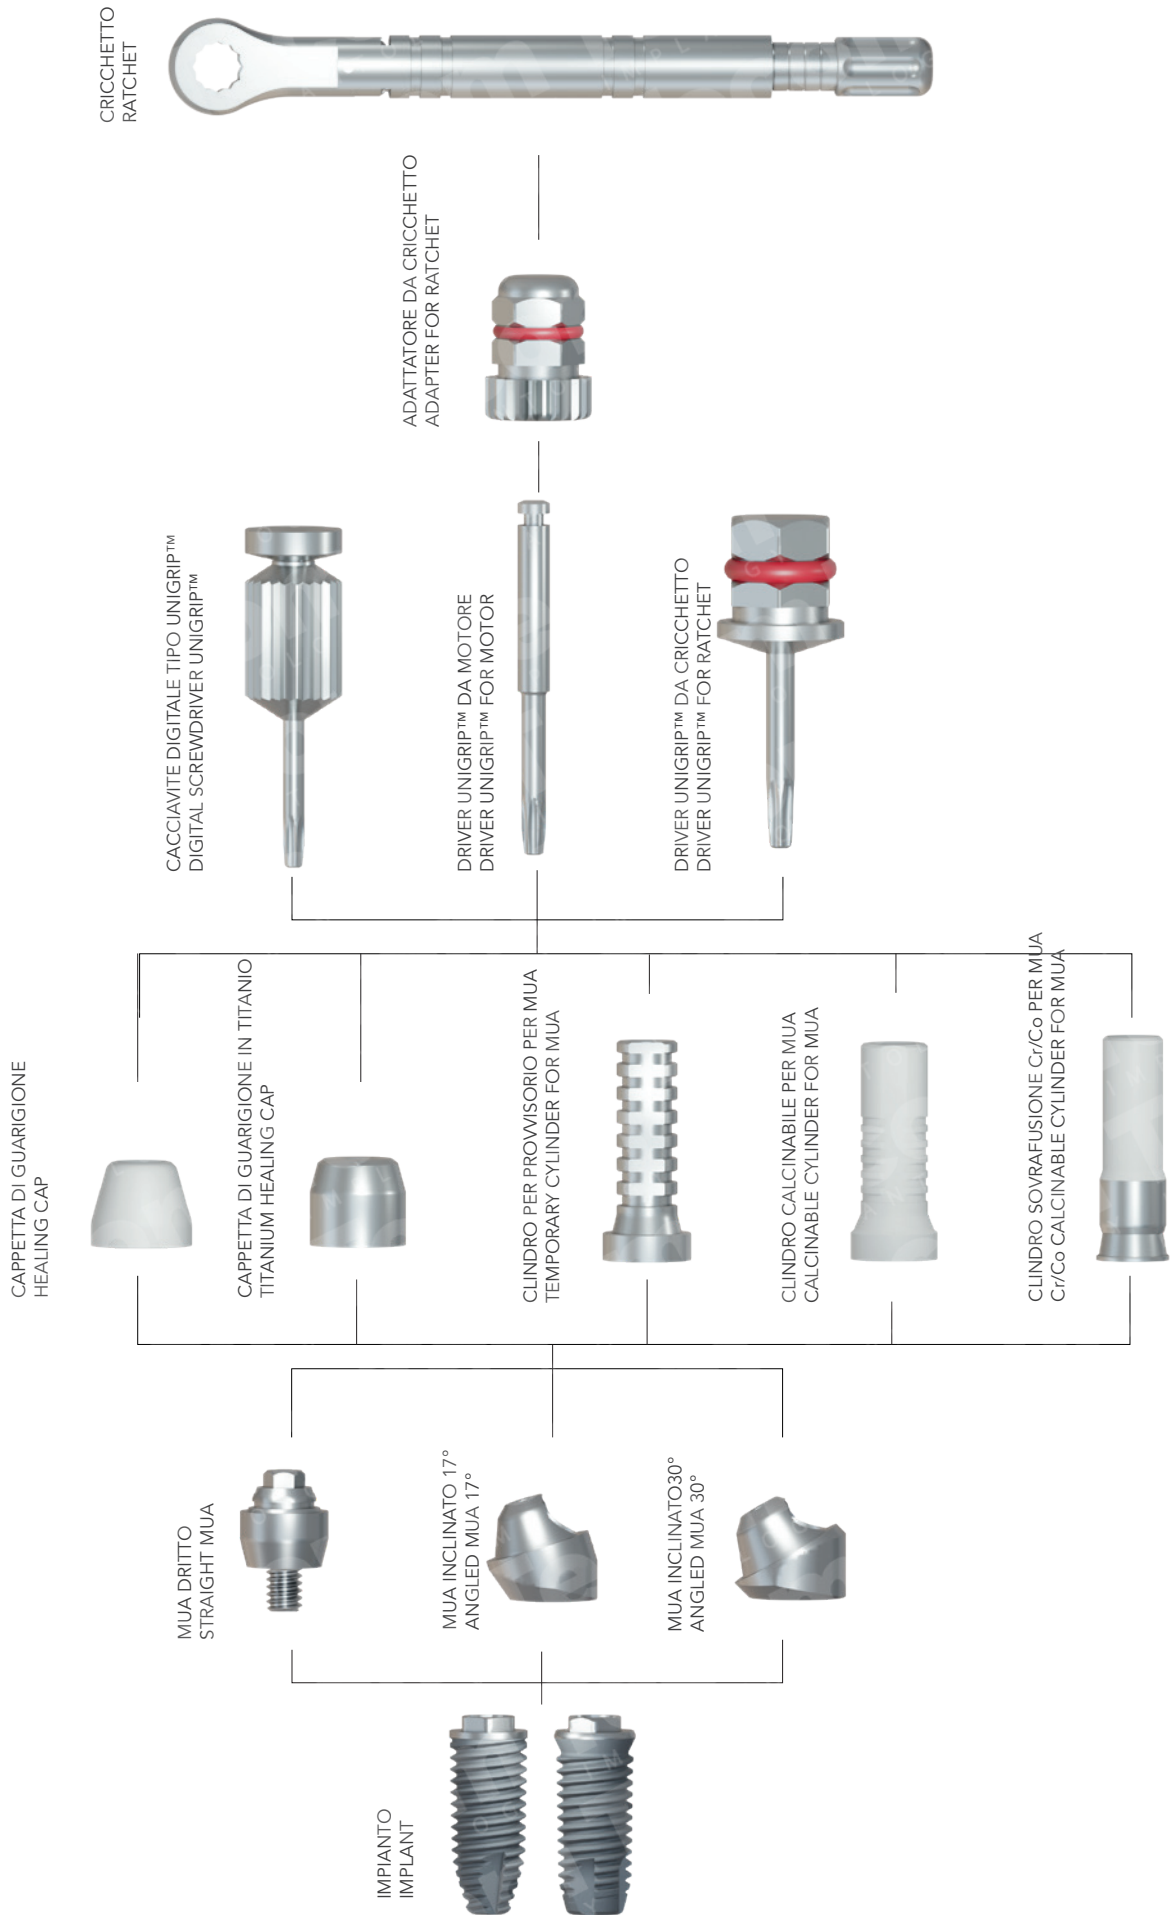

04 MUA MUA

MUA DRITTO STRAIGHT MUA



		H			
		1	2	3	4
Ø	3,75	BRAPPR074	BRAPPR075	BRAPPR098	BRAPPR099
	4	BRAPPR074	BRAPPR075	BRAPPR098	BRAPPR099
	5	BRAPPR076	/	/	/

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included


MUA INCLINATO 17° 17° ANGLED MUA



		H	
		2	3
Ø	3,75	BRAPPR103	BRAPPR104
	4	BRAPPR103	BRAPPR104

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MUA INCLINATO 30° 30° ANGLED MUA



		3	4	5
Ø	3,75	BRAPPR128	BRAPPR089	BRAPPR100
	4	BRAPPR128	BRAPPR089	BRAPPR100

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA

MUA LAB COMPONENTS



TRANSFER PER MUA CON VITE L 15
IMPRESSION COPING FOR MUA WITH SCREW L 15

BRAPPR087

VITE DI CONNESSIONE L 20 per transfer per MUA
CONNECTING SCREW L 20 for impression coping for MUA

BRAVIT042



ANALOGO PER MUA
MUA REPLICA

BRAPPR077

06 PARTI PROTESICHE MUA

MUA PROSTHETIC PARTS



CAPPETTA DI GUARIGIONE IN TITANIO PER MUA
TITANIUM HEALING CAP FOR MUA

BRAPPR141

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CAPPETTA DI GUARIGIONE PER MUA
HEALING CAP FOR MUA

BRAPPR097

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO PER PROVVISORIO PER MUA
TEMPORARY CYLINDER FOR MUA

BRAPPR086

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO SOVRAFUSIONE PER MUA Cr/Co
Cr/Co BASE FOR MUA CALCINABLE ABUTMENT

BRAPPR137

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO CALCINABILE PER MUA
CALCINABLE PLASTIC CYLINDER FOR MUA

BRAPPR108

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

07 STRUMENTARIO TOOLS



FRESA LANCEOLATA
PRECISION DRILL

VARSTR084



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SYSTEM PER OSSO
MORBIDO
DRILLING PROTOCOL FOR SOFT BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill

	1,6	1,8	2	2,8
3,3	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	/
3,75	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	/
4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	/
5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SYSTEM PER OSSO
MEDIO
DRILLING PROTOCOL FOR MEDIUM BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill

	1,6	1,8	2	2,8	3	3,25	3,4	3,55
3,3	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	/	/	/
3,75	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	BRASTR035	/	/	/
4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	BRASTR036	/	/
5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	BRASTR036	/	BRASTR038



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SYSTEM PER OSSO
DURO
DRILLING PROTOCOL FOR DENSE BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill

	1,6	1,8	2	2,8	3,25	3,4	3,55	4,25
3,3	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	/	/	/
3,75	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	BRASTR036	/	/	/
4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	RSTSTR001	/	/
5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	BRASTR036	/	BRASTR038	BRASTR037



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SPEEDY GR. PER OSSO MORBIDO

DRILLING PROTOCOL (SPEEDY GR. IMPLANTS) FOR SOFT BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill

		1,6	1,8	2
Ø	4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SPEEDY GR. PER OSSO MEDIO

DRILLING PROTOCOL (SPEEDY GR. IMPLANTS) FOR MEDIUM BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill

		1,6	1,8	2	2,8	3	3,25
Ø	4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	BRASTR036



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SPEEDY GR. PER OSSO DURO

DRILLING PROTOCOL (SPEEDY GR. IMPLANTS) FOR DENSE BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill

		1,6	1,8	2	2,8	3,4
Ø	4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	RSTSTR001



PIN DI PARALLELISMO

PARALLEL PIN

Ø	2/2,7	SFOSTR122
---	-------	-----------

Dotato di tacche di profondità per impianti H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

Depth indicator for implants H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

IMPLANT DRIVER TIPO STARGRIP™ DA MOTORE
IMPLANT DRIVER STARGRIP™ TYPE FOR MOTOR



	26	32
3,75	BRASTR019	BRASTR020
4	BRASTR019	BRASTR020
∅ 5	BRASTR021	BRASTR022

ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE
ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS



VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titanmed
This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets

IMPLANT DRIVER TIPO STARGRIP™ DA CRICCHETTO
IMPLANT DRIVER STARGRIP™ TYPE FOR RATCHET



	L	
	12	17
3,75	BRASTR055	BRASTR056
∅ 4	BRASTR055	BRASTR056
5	BRASTR053	BRASTR054

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets

CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 0,90
DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREWS HEX. 0,90



	L	
	10	15
	BRASTR025	BRASTR018



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™ TYPE

L	
12	17
BRASTR004	BRASTR015



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA MOTORE
DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR MOTOR

L	
26	32
BRASTR001	BRASTR027



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA CRICCHETTO
DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR RATCHET

L	
12	17
BRASTR057	BRASTR058

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets



CACCIAVITE DIGITALE PER OTK
DIGITAL SCREWDRIVER FOR OTK

BRASTR003



DRIVER PER OTK DA MOTORE
DRIVER FOR OTK FOR MOTOR

L
20
BRASTR014



DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE
DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR

		25
∅	3,75	BRASTR046
	4	BRASTR046



CRICCHETTO DINAMOMETRICO
TITANMED
DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET

VARSTR053

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



CRICCHETTO FISSO TITANMED
FIXED TITANMED RATCHET

VARSTR069

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



CACCIAVITE MANUALE PER STRUMENTI A CRICCHETTO
MANUAL SCREWDRIVER FOR RATCHETS INSTRUMENTS

L
170
VARSTR085

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



PROLUNGA PER FRESE
DRILL EXTENDER

VARSTR032



CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: ordini@tecomimplantology.com

CONTACTS

TITANMED S.r.l.

Administrative and operational location:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: orders@tecomimplantology.com

Titanmed

Leading to perfection

www.titanmed.it
www.tecomimplantology.com